


Alsident® System 50 Flex

Pressure Drop Chart - Druckverlustrdiagramm - Tryktabsdiagram

Tested by Danish Technological Institute.

Der Test ist vom Dänischen Technologischen Institut vorgenommen.

Test udført hos Teknologisk Institut.

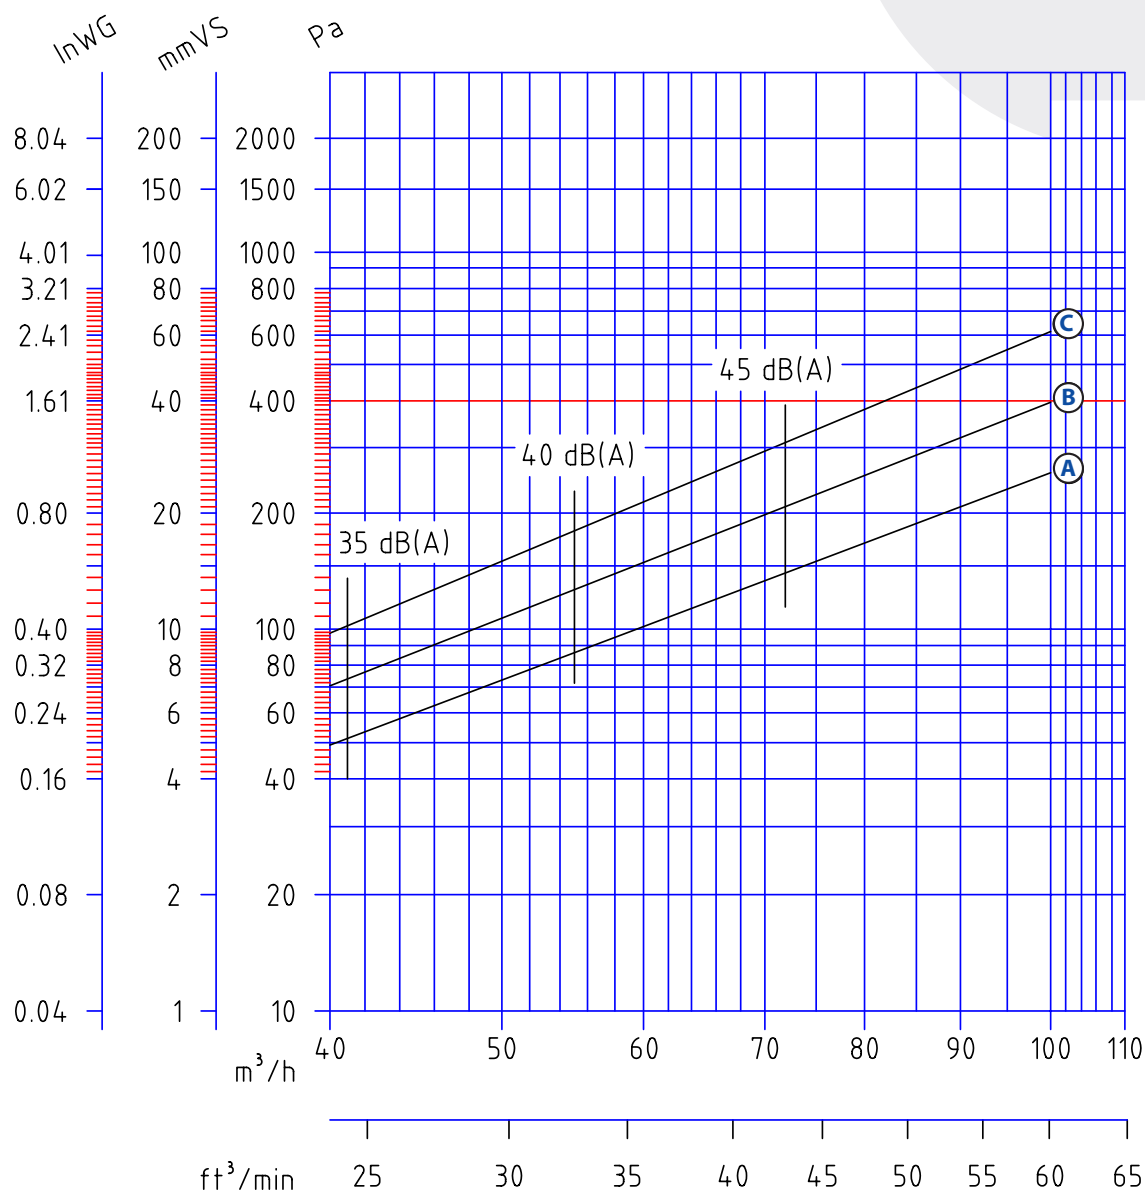

A No joints – Ohne Gelenk – Ingen led

B 1 joint – 1 Gelenk – 1 led

C 2 joints – 2 Gelenke – 2 led

